

ПрАТ «Івано-Франківськцемент»
Івано-Франківська обл.,
Тисменицький р-н, с.Ямниця, 77422
www.ifcem.if.ua market@ifcem.if.ua
тел. +38 0342 58-36-67



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 26
На бинти гіпсові медичні БГМ-Н ТМ «KRUMed»
ТУ У 24.4-00292988-001:2007 зі змінами №1, №2, №3.



Умовне позначення

БГМ-Н

Дата виготовлення	Номер партії	Показники якості							Кількість	
		Лінійні розміри		Обсипання гіпсового в'язучого, %	Відсутність запаху сірководню або інших запахів хімічних речовин	Кількість гіпсу в г на 1 м²	Терміни утворення			
		Довжина, см	Ширина, см				Початок хв, сек	Кінець хв, сек		
									Вимоги стандарту	
		270±5 300±5	10±0,5 15±0,5 20±0,5	≤ 7,0	при замочуванні у воді не повинно виділятися запаху	300-450	≥ 2 хв	≤ 8хв		
19.11.19р	39	270	10	25	відсутній	435,6	2 ²⁰	5 ⁵⁰	1	68
12.03.19р	30	270	15	25	-11-	444,4	2 ²⁰	6 ¹⁰	2	90
29.11.19р	47	270	20	26	-11-	443,6	2 ¹⁰	6 ²⁰	2	68

Гарантійний термін зберігання бинтів гіпсових медичних – 5 років.

Радіаційна безпека - згідно НРБУ – 97, бинти гіпсові медичні відносяться до І класу і можуть використовуватись без обмежень.

Відвантажено: 11.08.2020р

АЧ 7662 АЕ


ТОВ «КРЕДІО»

(дата, номер транспортного засобу, адреса споживача)

Випробувальна лабораторія виробництва в'язучих матеріалів ПрАТ «Івано-Франківськцемент» акредитована в НААУ на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 атестат акредитації №2Т062

Виробництво продукції сертифіковане на відповідність ДСТУ ISO 13485:2018 та EN ISO 13485:2016, сертифікат на систему управління якістю № 203295/A/0001/UK/En. Виробництво продукції сертифіковане на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015, сертифікат на систему управління якістю № UA.IF.QMS.53-19 та на відповідність ISO 9001:2015, сертифікат на систему управління якістю № UA.IF.QMS.54-19

Начальник лабораторії
з контролю в-ва та випробувань

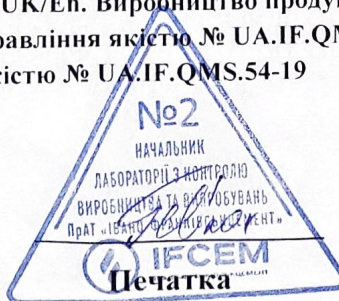

І. М. Гев'юк

41 » 08 2020 р.