



10023  
ISO/IEC 17065



UA.TR.001

Зареєстровано за №  
Ref. Certif. No.

**UA.TR.001 48-17**  
**Rev. 0**

**Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»  
(ДП «Укрметртестстандарт»)**

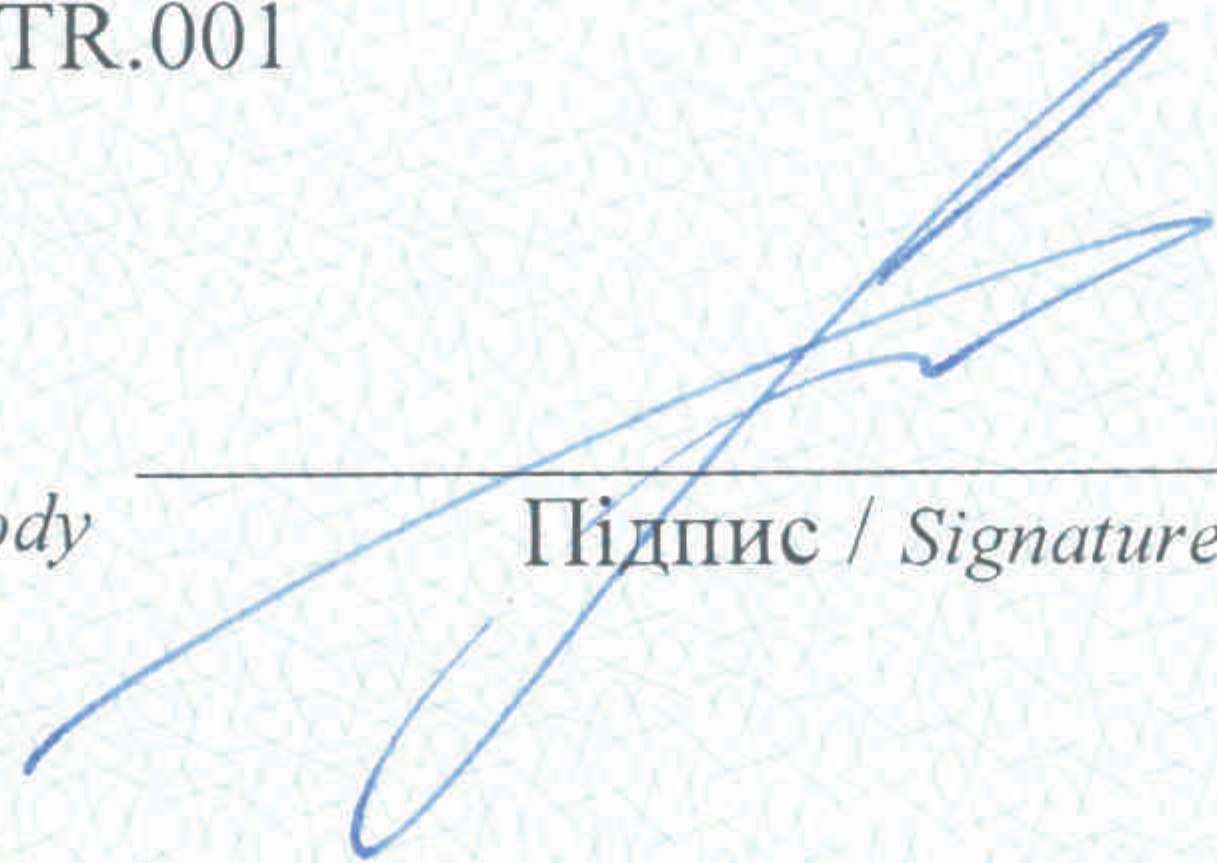
*State Enterprise «All-Ukrainian State Research and Production Center for Standardization, Metrology, Certification and Consumers' Rights Protection» (SE "Ukrmetrteststandart")*

**СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ**  
*Type-examination Certificate*

Виданий: <i>Issued to:</i>	Sensus Slovensko a.s. Nam. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stara Tura, Slovakia
Відповідно до: <i>In accordance with:</i>	Додатку 2, розділ «Модуль В: перевірка типу» до Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 163 <i>Annex II, section «Module B: type examination» of the Technical regulation on measuring instruments approved by the decision of The Cabinet of Ministers of Ukraine of 24 February 2016 № 163</i>
Тип засобу вимірювальної техніки: <i>Type of measuring instrument:</i>	Лічильник води <i>Water meter</i>
Позначення типу: <i>Type designation:</i>	MeiTwin, WPV-MS 150
Дійсний до: <i>Valid until:</i>	14.06.2027
Дата видачі: <i>Date of issue:</i>	14.06.2017
Кількість сторінок: <i>Number of pages:</i>	16
Номер для посилань: <i>Reference №:</i>	24/2/B/1/135-17
Номер призначеного органу: <i>Number of Designated body:</i>	UA.TR.001

**Заступник керівника  
органу з оцінки відповідності**  
*Deputy director of Conformity Assessment Body*

М.П.  
*Official stamp*

  
Підпис / *Signature*

**Ю.В. Кузьменко**  
*Iu.V. Kuzmenko*  
Ініціали, прізвище / *Name*

Даний сертифікат перевірки типу може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката перевірки типу можливе лише з письмової згоди Призначеного органу, що його видав. Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.  
*This Type-examination certificate may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Type-examination certificate requires written permission of the issuing Designated body. Type-examination certificates without signature and stamp are not valid.*

Адреса ДП "Укрметртестстандарт" : 4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна  
*Address SE "Ukrmetrteststandart" : 4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine*  
Телефон/Phone: +38 (044) 526-52-29, факс/fax: +38 (044) 526-42-60, ел.пошта/e-mail: ukrscm@ukrcsm.kiev.ua  
web-сайт/website: www.ukrcsm.kiev.ua