

Стосується каталожних номерів:  
51521; 51522; 51523; 51524; 51527; 51528; 51519.

#### Відтинки:

NT Premium Flow Enamel: A1, A2, A3, A3,5, A4, B2  
NT Premium Flow Transparent

#### Опис:

NT Premium Flow - це наногібридна композитна смола високої текучості, призначена для застосування в препарованих порожнинах зуба, без необхідності тиску або конденсації, що створює тісний зв'язок матеріалу із стінками зуба.

#### Показання до застосування:

- Завдяки меншій в'язкості легко застосовується в реставрації III і V класу, а також показані для малоінвазивних препарувань порожнини зуба (в т.ч. малі оклюзійні реставрації та пломби) і ремонт крайових дефектів в існуючі раніше реставрації.
- Рекомендується також для ремонту дрібних дефектів непрямих порцелянових реставрацій;
- Завдяки своїй текучості та еластичності (нижче навантаження) ідеально підходить для підкладки та основи (початкових шарів) реставрацій I та II класи;
- Герметизація фісур;
- Фіксація порцелянових вінірів.

#### Пакування:

- 1 шприц по 2 г
- 2 канюлі для аплікації.
- 1 Інструкція з експлуатації.

#### Склад:

мономери (Bis-GMA, Bis-EMA, TEGMA), ВНТ, фотоініціатори, наповнювачі та пігменти.

#### Інструкція по застосуванню:

1. Препарувати порожнину зуба за звичайною методикою.
2. Внесення адгезивної системи відповідно до інструкції використання виробника.
3. Внесіть NT Premium Flow безпосередньо в порожнину.
4. Не наносьте шари товщиною більше 2 мм, щоб оптимізувати полімеризацію.
5. Після завершення нанесення відтягніть поршень шприца назад, щоб уникнути додатковий витік матеріалу.
6. Полімеризуйте світлом протягом 40 секунд.
7. Використовуйте традиційний метод і матеріали для реставрації.
8. Для полірування використовуйте неабразивні диски або резинки.

#### Запобіжні заходи, обмеження та попередження:

- Запобіжні заходи

Використовувати лише відповідно до інструкції з експлуатації. Використання, іншими методами від описаного в інструкції із застосування, є виключною відповідальністю фахівця. Уникайте контакту зі слиною та кров'ю під час застосування. Рекомендується застосовувати кофердам, щоб уникнути контакту рідин (слина, кров) з матеріалом. Ця смола чутлива до світла, тому якщо навколишнє освітлення занадто інтенсивне це може спричинити передчасну полімеризацію. Тримайте шприц завжди закритим, коли він не використовується. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не використовується з продуктами, що містять фенол, масло гвоздики, лак копалові або цинкооксидні цементи з евгенолом, оскільки вони запобігають або впливають на полімеризацію. Знебарвлення може статися, якщо ви використовуєте катіонні рідини для полоскання рота, а також проявники нальоту і хлоргексидин. Після використання шприц повинен бути щільно закритий. Виключно для використання ліцензованих стоматологів.

- Обмеження та застереження

Стосується каталожних номерів:  
51521; 51522; 51523; 51524; 51527; 51528; 51519.

#### Відтинки:

NT Premium Flow Enamel: A1, A2, A3, A3,5, A4, B2  
NT Premium Flow Transparent

#### Опис:

NT Premium Flow - це наногібридна композитна смола високої текучості, призначена для застосування в препарованих порожнинах зуба, без необхідності тиску або конденсації, що створює тісний зв'язок матеріалу із стінками зуба.

#### Показання до застосування:

- Завдяки меншій в'язкості легко застосовується в реставрації III і V класу, а також показані для малоінвазивних препарувань порожнини зуба (в т.ч. малі оклюзійні реставрації та пломби) і ремонт крайових дефектів в існуючі раніше реставрації.
- Рекомендується також для ремонту дрібних дефектів непрямих порцелянових реставрацій;
- Завдяки своїй текучості та еластичності (нижче навантаження) ідеально підходить для підкладки та основи (початкових шарів) реставрацій I та II класи;
- Герметизація фісур;
- Фіксація порцелянових вінірів.

#### Пакування:

- 1 шприц по 2 г
- 2 канюлі для аплікації.
- 1 Інструкція з експлуатації.

#### Склад:

мономери (Bis-GMA, Bis-EMA, TEGMA), ВНТ, фотоініціатори, наповнювачі та пігменти.

#### Інструкція по застосуванню:

1. Препарувати порожнину зуба за звичайною методикою.
2. Внесення адгезивної системи відповідно до інструкції використання виробника.
3. Внесіть NT Premium Flow безпосередньо в порожнину.
4. Не наносьте шари товщиною більше 2 мм, щоб оптимізувати полімеризацію.
5. Після завершення нанесення відтягніть поршень шприца назад, щоб уникнути додатковий витік матеріалу.
6. Полімеризуйте світлом протягом 40 секунд.
7. Використовуйте традиційний метод і матеріали для реставрації.
8. Для полірування використовуйте неабразивні диски або резинки.

#### Запобіжні заходи, обмеження та попередження:

- Запобіжні заходи

Використовувати лише відповідно до інструкції з експлуатації. Використання, іншими методами від описаного в інструкції із застосування, є виключною відповідальністю фахівця. Уникайте контакту зі слиною та кров'ю під час застосування. Рекомендується застосовувати кофердам, щоб уникнути контакту рідин (слина, кров) з матеріалом. Ця смола чутлива до світла, тому якщо навколишнє освітлення занадто інтенсивне це може спричинити передчасну полімеризацію. Тримайте шприц завжди закритим, коли він не використовується. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не використовується з продуктами, що містять фенол, масло гвоздики, лак копалові або цинкооксидні цементи з евгенолом, оскільки вони запобігають або впливають на полімеризацію. Знебарвлення може статися, якщо ви використовуєте катіонні рідини для полоскання рота, а також проявники нальоту і хлоргексидин. Після використання шприц повинен бути щільно закритий. Виключно для використання ліцензованих стоматологів.

- Обмеження та застереження

NT Premium Flow повинен використовуватися відповідно до інструкції використання. Не застосовувати у пацієнтів, які мають алергію на компоненти цього продукту. В якості профілактики, якщо препаровані стінки порожнини знаходяться близько до пульпи, слід використовувати гідроксид кальцію, склоіономерний цемент або інший тип прокладочного матеріалу перед тим, як вносити матеріал у порожнину.

#### **Термін придатності:**


За відповідних умов зберігання NT Premium Flow термін придатності 36 місяців. Термін придатності, який вказано на упаковці, означає термін придатності максимальне використання продукту. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

#### **Зберігання:**

Товар повинен залишатися в оригінальній упаковці, яка повинна закриватися після використання. Зберігати при кімнатній температурі (15°C - 30°C), у сухому захищеному від світла та тепла місці. Пряме попадання світла може змінити властивості NT Premium Flow.

#### **Утилізація:**

Утилізуйте відповідно до чинних вимог утилізації медичних відходів відповідно законодавству України. Можна утилізувати разом із побутовими відходами відповідно до офіційних правил та погодження з уповноваженими компаніями утилізації відходів та уповноваженими органами. Утилізувати тільки повністю випорожнені упаковки.

 **VIGODENT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**  
Rua Pesqueira, 26 – Bonsucesso 21041-150, Rio de Janeiro, Brazil  
**ВІГОДЕНТ ІНДАСТРІА Е СОМЕРСІО ЛТДА**  
Руа Пескейра, 26 – Бонсуцессо 21041-150, Ріо-де-Жанейро,  
Бразилія

#### **Уповноважений представник в Україні:**


##### **ТОВ «МЕДРИНОК»**

43020, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул.  
Зв'язківців, буд. 6  
medrynok.pro  
medrynok.corp@gmail.com  
тел. +380 50 157 42 07



UA.TR.130

#### **Пояснення символів**

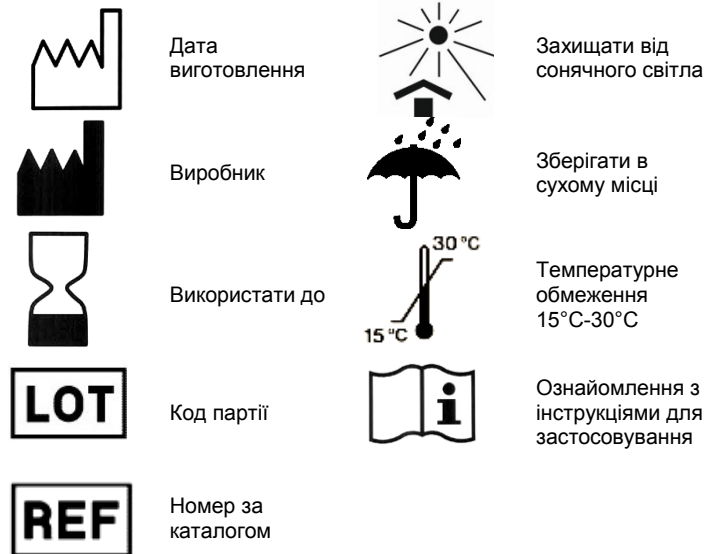

Версія: 1.0

Дата останнього перегляду: 01.05.2025

NT Premium Flow повинен використовуватися відповідно до інструкції використання. Не застосовувати у пацієнтів, які мають алергію на компоненти цього продукту. В якості профілактики, якщо препаровані стінки порожнини знаходяться близько до пульпи, слід використовувати гідроксид кальцію, склоіономерний цемент або інший тип прокладочного матеріалу перед тим, як вносити матеріал у порожнину.

#### **Термін придатності:**


За відповідних умов зберігання NT Premium Flow термін придатності 36 місяців. Термін придатності, який вказано на упаковці, означає термін придатності максимальне використання продукту. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

#### **Зберігання:**

Товар повинен залишатися в оригінальній упаковці, яка повинна закриватися після використання. Зберігати при кімнатній температурі (15°C - 30°C), у сухому захищеному від світла та тепла місці. Пряме попадання світла може змінити властивості NT Premium Flow.

#### **Утилізація:**

Утилізуйте відповідно до чинних вимог утилізації медичних відходів відповідно законодавству України. Можна утилізувати разом із побутовими відходами відповідно до офіційних правил та погодження з уповноваженими компаніями утилізації відходів та уповноваженими органами. Утилізувати тільки повністю випорожнені упаковки.

 **VIGODENT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**  
Rua Pesqueira, 26 – Bonsucesso 21041-150, Rio de Janeiro, Brazil  
**ВІГОДЕНТ ІНДАСТРІА Е СОМЕРСІО ЛТДА**  
Руа Пескейра, 26 – Бонсуцессо 21041-150, Ріо-де-Жанейро,  
Бразилія

#### **Уповноважений представник в Україні:**


##### **ТОВ «МЕДРИНОК»**

43020, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул.  
Зв'язківців, буд. 6  
medrynok.pro  
medrynok.corp@gmail.com  
тел. +380 50 157 42 07



UA.TR.130

#### **Пояснення символів**

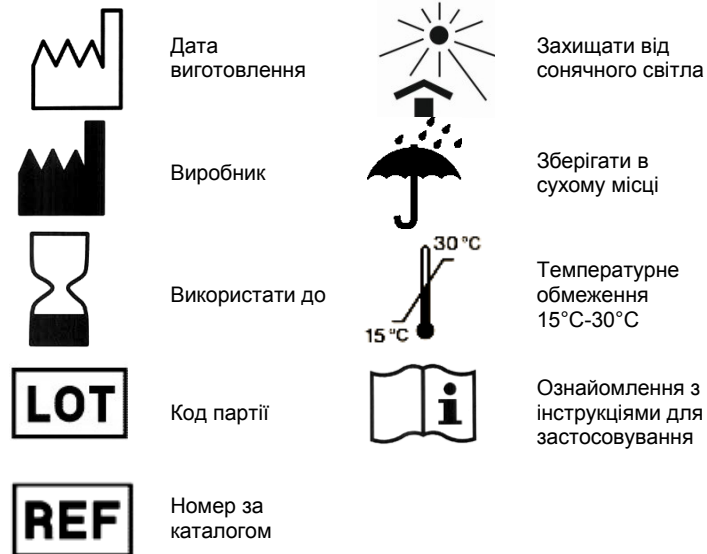

Версія: 1.0

Дата останнього перегляду: 01.05.2025